

Thermomètre pour mesure rapide

testo 905

Lecture aisée grâce à la tête pivotante

Etendue de mesure élevée


Mesure à hautes températures, jusqu'à 500 °C
(courte durée)

Temps de réponse très rapide

Utilisation simple

Grand écran

Fonction Auto-Off

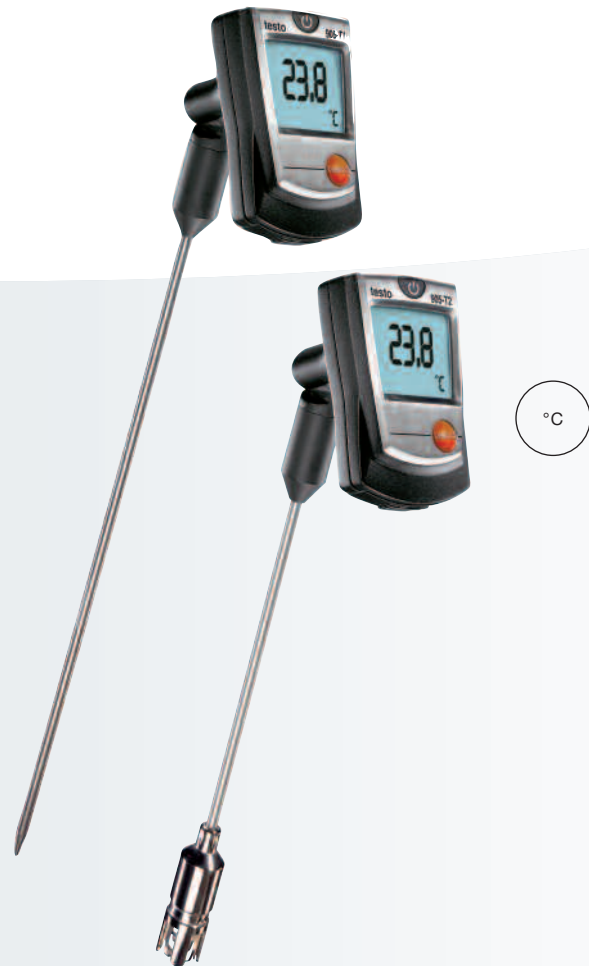

Le testo 905-T1 est l'un des mini-thermomètres d'immersion les plus rapides avec une large étendue de mesure de -50 à +350°C, à court terme (1-2 mn) jusqu'à +500°C.

Le thermomètre possède un capteur professionnel (thermocouple type K). Ce thermocouple a une bonne précision surtout pour des températures élevées.

Le testo 905-T2 est un mini-thermomètre de contact avec une large étendue de mesure de -50 à +350°C, à court terme (1-2 mn) jusqu'à +500°C. Sa large tête de mesure à thermocouple K à lamelles souples garantit un temps de réponse très rapide et une précision élevée par un bon contact de la sonde.


Les 2 instruments possèdent une tête pivotante qui permet de lire les résultats dans toutes les positions.

Données techniques / Accessoire(s)

testo 905-T1

testo 905-T1; thermomètre de pénétration avec clip de fixation, fixation en gaine, pile et mode d'emploi


Réf. 0560 9055



testo 905-T2

testo 905-T2; thermomètre de contact avec sonde à lamelles souples, clip de fixation et pile

Réf. 0560 9056



Données techniques

	testo 905-T1	testo 905-T2
Etendue	-50 ... +350 °C (court terme: +500 °C)	-50 ... +350 °C (court terme: +500 °C)
Précision ±1 Digit	±1 °C (-50 ... +99.9 °C) ±1% v.m. (étendue restante)	±(1 °C ±1% v.m.)
Résolution	0.1 °C	0.1 °C
Temp. d'utilisation	0 ... +40 °C	0 ... +40 °C
Temp. de stock.	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C
Type de pile	3 piles mignon AAA	3 piles mignon AAA
Autonomie	1000 h	1000 h
Tps de réponse	10 sec.	5 sec.
Type de réponse	t ₉₉ (dans de l'eau)	t ₉₉
Affichage	LCD 1 ligne	LCD 1 ligne
Poids	80 g	80 g
Garantie	2 ans	2 ans

Accessoire(s) Réf.

Accessoire(s) pour appareil testo 905-T1

Certificat d'étalonnage raccordé en température pour sonde d'ambiance/immersion, pt d'étalonnage 0°C	0520 0062	
Certificat d'étalonnage raccordé en température pour sonde d'ambiance/pénétration, pt d'étalonnage -18 °C	0520 0061	
Certificat d'étalonnage raccordé en température pour sonde d'ambiance/immersion, pt d'étalonnage +60 °C	0520 0063	
Certificat d'étalonnage raccordé en temp. thermomètre avec sonde d'ambiance/immersion, pts -18°C; 0°C; +100°C	0520 8001	

Accessoire(s) Réf.

Accessoire(s) pour appareil testo 905-T2

Certificat d'étalonnage raccordé en temp. étalonnage à 1 point pour thermomètre avec sonde de surface; +120 °C	0520 0073	
Certificat d'étalonnage raccordé en temp. étalonnage à 1 point pour thermomètre avec sonde de surface; +60 °C	0520 0072	
Certificat d'étalonnage raccordé en température thermomètre avec sonde de surface; pts d'étalonnage +60°C; +120°C	0520 8071	
Certificat d'étalonnage raccordé en température thermomètre avec sonde de contact; pts d'étalonnage au choix de -15 ... +480 °C	0520 0121	

A.F.M.I.L



Adresse : 27, Rue Vercingetorix,
Roches Noires 20290,
Casablanca, Maroc

Phone : 00 212-522 24 01 84
00 212-522 24 69 29

Fax : 00 212-522 24 01 87

E-mail : commercial@afmil-word.com

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo
19, rue des Maraîchers
57600 FORBACH
Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18
info@testo.fr

www.testo.fr